MULTIPLE-WAVELENGTH LIGHT MEASURING INSTRUMENT

Patent number:

JP6317526

Publication date:

1994-11-15

Inventor:

IZUNO GUNPEI

Applicant:

OLYMPUS OPTICAL CO LTD

Classification:

G01N21/64


- european:

JP19930104636 19930430

Application number: Priority number(s):

Abstract of JP6317526

PURPOSE:To provide a multiple-wavelength light measuring instrument which can obtain an accurate measured value even if the difference in incidence fluorescent intensity between photo multiplexers deviates from the dynamic range of the photo multiplexers. CONSTITUTION: The title instrument is provided with a light branch element 21 branching from a body S to be inspected, a plurality of wavelength selection elements 22 and 24 where the light branched by the light branching element 21 enters, a plurality of photoelectric converters 23 and 25 for detecting the light intensity of the wavelength selected by the wavelength selection elements 22 and 24, a sensitivity control means 32 for controlling the sensitivity of the photoelectric converters 23 and 25 based on the output of the photoelectric converters 23 and 25 individually, and compensation means 32 and 36 for compensating the output of the photoelectric converters 23 and 25 whose sensitivity is controlled by the sensitivity control means 32 to a measured value at a reference sensitivity of the photoelectric converters 23 and 25.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)



(11)特許出願公開番号 特開平6-317526

(43)公開日 平成6年(1994)11月15日

(51)Int.Cl.5 G01N 21/64

庁内整理番号 織別記号 Z 7414-2 J

FI

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 9 頁)

(21)出顯番号 (22)出頭日

特顯平5-104636

平成5年(1993)4月30日

(71)出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 伊津野 郡平

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内


(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称 】 多波長測光装置

(57) 【要約】

【目的】本発明の目的は、フォトマル間の入射蛍光強度 の差がフォトマルのダイナミックレンジから逸脱する場 合にも正確な測定値を得ることのできる多波長測光装置 の提供にある。

【構成】被検査体Sからの分岐する光分岐素子21と、 この光分岐素子21で分岐された光が入射する複数の波 長選択素子22,24と、これら各波長選択素子22, 24により選択された波長の光強度を夫々検出する複数 の光電変換器23,25と、これら各光電変換器23, 25の出力に基づいて前記各光電変換器23,25の感 度を個々に制御する感度制御手段32と、この感度制御 手段32が感度制御した光電変換器23,25の出力を 当該光電変換器23,25の基準感度での測定値に補正 する補正手段32,36とを具備して構成される。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検査体からの光を複数に分岐する光分 岐素子と、この光分岐案子で分岐された光の各光路上に 配置され各々異なる波長選択特性を持つ複数の波長選択 素子と、これら各波長選択素子により選択された波長の 光強度を夫々検出する複数の光電変換器と、これら各光 電変換器の出力に基づいて前記各光電変換器の感度を倒 々に制御する感度制御手段と、この感度制御手段が感度 制御した光電変換器の出力を当該光電変換器の基準感度 での測定値に補正する補正手段とを具備したことを特徴 10 とする多波長測光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、複数の光電変換器を備 えた多波長測光装置に係り、さらに詳しくは光強度に応 じてダイナミックレンジを変更する多波長測光装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】被検査体となる細胞に所定の蛍光試薬を 投与して、その細胞に励起光(波長340nm)を照射 すると、その細胞の蛍光像が図6に示す如く変化する蛍 光スペクトルの光を発することが知られている。この蛍 光スペクトルの2波長間の比は細胞内に含まれるカルシ ウムイオン濃度に応じた値となる。そこで上記蛍光像を 2波長測光して2波長間の測光値の比を求めることによ り、細胞内のカルシウムイオン濃度を測定することがで きる。2波長測光機能を備えた蛍光顕微鏡装置が特開平 2-28542号公報に記載されている。

【0003】図5は、特開平2-28542号公報に記 載された蛍光顕微鏡装置の概略的な構成を示している。 この蛍光顕微鏡装置は水銀ランプ1の光をNDフィルタ ーユニット 2,励起フィルタユニット 3 及びダイクロイ ックミラー4を介して試料5に照射する。試料5に所定 の蛍光試薬を投与しておき、波長340nmの励起光を 励起フィルタユニット3で選択しておけば、励起された 試料5からカルシウムイオン濃度等に応じて蛍光スペク トルが図6に示す如く変化する光が発せられる。試料5 からの光はダイクロイックミラー 4 を通過し吸収フィル タユニット6を介してTVカメラ7に入射する。

【0004】透過波長が410nm, 460nmの2つ 40 の吸収フィルター 6 a , 6 b を吸収フィルタユニット 6 に設け、吸収フィルター 6 a , 6 b を所定速度で光路上 に交互に挿入することにより波長410 n mの蛍光強度 と波長460mmの蛍光強度とに応じた信号がTVカメ ラ 7 から出力される。この 2 信号の比からカルシウムイ オン濃度を測定できる。

【0005】ところで、互いに異なる2波長の蛍光強度 を測定するため、励起光の強度や試料5の状態によって は、一方の波長の光強度がTVカメラ7のダイナミック レンジに入らなくなる場合もある。

【0006】そこで上述した蛍光顕微鏡装置では、TV カメラ7のダイナミックレンジを有効に使用するため、 NDフィルタユニット2で励起光強度を調整している。 また、2つの光電子増倍管(以下、フォトマルと呼称す る)を使って2波長測定を行う蛍光顕微鏡装置が特開昭 55-74448号公報に記載されている。この公開公 報に記載された蛍光顕微鏡装置は、図7に示すように構 成され、光源10からの光を励起フィルター11,ダイ クロイックミラー12を介して試料13に入射し、その 試料13からの蛍光をダイクロイックミラー12, ハー フミラー14を介して光分割プレート15に入射してい る。光分割プレート15で分割された一方の光を吸収フ ィルター16を介してフォトマル17で検出し、もうー 方の光を吸収フィルター16と異なる透過波長域を持つ 吸収フィルター18を介してフォトマル19で検出して いる.

【0007】2つのフォトマル17,19の各々で検出 された各波長の蛍光強度を成分関係決定装置20に入力 して互いの強度比をCRT甌面上にプロットし、そのプ ロット位置(強度比)を検出して標本が目的のものであ るか否か判断している。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図5に 示す蛍光顕微鏡装置は、2波長の双方の蛍光強度をTV カメラ7のダイナミックレンジ内に収めるために励起光 強度をNDフィルターを使って調整しているので、光量 損失が大きく、励起光強度が不十分となって良好な蛍光 像が得られなくなる可能性がある。

【0009】また図7に示す蛍光顕微鏡装置は、励起光 の光量損失はほとんど問題とならないが、各フォトマル 17,19の感度が固定となっているため、蛍光強度が 大きすぎてフォトマル17, 19のダイナミックレンジ を越えてしまうような場合、又は蛍光強度が小さすぎて 十分な検出精度を得られなくなるような場合には対処で きないので、そのような時は測定精度が著しく低下する という問題がある。

【0010】本発明は以上のような実情に鑑みてなされ たもので、励起光の光量損失が小さく常に良好な蛍光像 を得ることができると共に、蛍光強度がTVカメラやフ オトマルのダイナミックレンジから逸脱しているような 場合であっても高い測定精度を実現できる多波長測光装 置を提供することを目的とする。

[0011] 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明の多波長測光装置は、被検査体からの光を複数 に分岐する光分岐素子と、この光分岐素子で分岐された 光の各光路上に配置され各々異なる波長選択特性を持つ 複数の波長選択素子と、これら各波長選択素子により選 択された波長の光強度を夫々検出する複数の光電変換器 50 と、これら各光電変換器の出力に基づいて前記各光電変



換器の感度を個々に制御する感度制御手段と、この感度 制御手段により感度制御された光電変換器の出力を当該 光電変換器の基準感度での測定値に補正する補正手段と を具備する構成とした。

[0012]

【作用】本発明の多波長測光装置では、被検査体からの 光が光分岐素子により複数に分岐され、その分岐された それぞれの光が対応する各波長選択素子に入射して特定 波長が選択される。そして各波長選択素子で選択された 各波長の光強度が各々対応する光電変換器で検出され 10 る。各光電変換器の感度は感度制御手段により光電変換 器の出力に基づいて制御される。すなわち、感度制御手 段は光電変換器の出力から入射光強度がダイナミックレ ンジを越えるほど大きいのか、又は入射光強度が十分な 測定精度が得られないほど小さいのかを判断することが できる。入射光強度が大きすぎる場合には該当する光電 変換器の感度を下げる。また、入射光強度が小さすぎる 場合には該当する光電変換器の感度を上げる。このよう な感度制御により入射光強度が光電変換器のダイナミッ クレンジから逸脱するのを防止することができる。感度 20 制御手段により感度制御が行われた光電変換器の出力は 補正手段により当該光電変換器の基準感度での測定値に 補正される。

[0013]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。図 1 は本発明の一実施例に係る多波長測光装置の全体構成 を示している。本実施例の多波長測光装置は、被検査体 としての発光体 5 からのたをグイクロイックミラー 2 1 で透過成分と反射成分の2成分に分岐する。ダイクロイックミラー 2 1 の活過光を、その透過光の光路上に配置 30 された第1 の吸収フィルター 2 2 を通して第1のフォト マル2 3 に入射する。またダイクロイックミラー 2 1 の 反射光を、その反射光の光路上に配置された第2 の吸収 フィルター 2 4 を通して第2 のフォトマル2 5 に入射する。第1 の吸収フィルター 2 は活過成分の有する波長 域のうち特定波長域の光のみを活過する波長連択特性を 有している。第2 の吸収フィルター 2 4 は反射成分の有 する波長域の方の策2 5 第1 の吸収フィルター 2 4 は反射成分の有 する波長域の方の気で透過する被反響が特性を 有している。第2 の吸収フィルター 2 4 は反射成分の有 する波長域の方の気で透過する被反響が特性を 定設長域の方のみを透過する被反響が分の有 定数長域の方の表で透過する被反響が特性を有してい

10014】第1のフォトマル23は電圧制御回路26 から動作に必要な電圧が印加される。電圧制御回路26 は後述するCPUから受情する感度指令信号に基づいて 第1のフォトマル23に、入射光を受光する蛍光面と、そ の蛍光面から発せられる光電子を増倍する電極群とから 構成されており、電極群両端間の電圧勾配を変化させる とにより、光電子増倍率すなわち感度が変化する。同 様に、第2のフォトマル25は、24世紀期間回路27から動 作電圧が印測されており、その印加電圧はCPUからの 50

感度指令信号に基づいて変化される。

【0015】第1のフォトマル23で検出した測光値は電流/電圧変換回路28で電圧信号に変換され、その電圧信号が比較回路29に入力する。比較回路29は第1のフォトマル23のダイナミックレンジの最大値近形でとめられたしきい値Vrefが設定されており、入力する電圧信号の電圧値がしまい値Vrefを越えるまでは電圧信号を出力し、電圧信号の電圧値がしまい値Vrefを越えると電圧信号の出力を停止する。この比較回路29から出力される電圧信号はA/D変換器31を介してCPU32に入力している。

【0016】また第2のフォトマル25で検出した測光値は、電流/電圧変換回路33で電圧信号に変換され、その電圧信号がは映回路34に入力する。比較回路3はは第2のフォトマル25のダイナミックレンジの最大値近傍に定められたしきい値Vreが設定されており、入力する電圧信号に対して上記比較回路35と同様に動作する。この比較回路35から出力される電圧信号は人/D変換器35を介してCPU32に入力している。【0017】CPU32は図2及び図3に示すフローチャトに基づいて第1,第2のフォトマル23,25の感度補正を行うと共に、各フォトマル23,25で検出した電光強度と感度物性アーブル36に格納された感度

特性データとを用いて後述する演算を実施する。 【0018】感度特性テーブル28には図4に示すよう な第1、第2のフォトマル23、25の感度特性が格納 されている。図4(a)の下段のグラフは第1のフォト マル23の感度特性を示している。機軸の印加電圧と縦

軸の蛍光強度との比がフォトマル感度となる。図4 (b) の下段のグラフが第2のフォトマル25の感度特性を示している。

[0019] 次に、細胞に所定の蛍光試薬を投与し酸細胞に所定波長の励起光を照射し、図6に示すような蛍光 スペクトルの蛍光像を細胞から発光させ、その蛍光像を 2 波長測光して細胞内のカルシウムイオン濃度を調定す る場合の動作について説明する。

【0020】先ず、第1のフォトマル23と第2のフォトマル25を同一感度に設定する。そのため、感疫特性 テーブル36に格納された第1のフォトマル23の感度 特性と第2のフォトマル25の感度特性とから双方の感度が同じになる基準電圧HV1、HV2を決定する。本明細書では、この感度を基準感度と呼ぶ。例えば、基準電圧HV1、HV2に応た基準感度に、第1のフォトマル23のダイナミックレンジの中間値と第2のフォトマル25のダイナミックレンジの中間値との中間の値を用いる。

【0021】第1のフォトマル23は電圧制御回路26 により第1の基準電圧HV1が印加され、第2のフォト マル25は電圧制御回路27により基準電圧HV2が印加される。

検出した I HV2 との比を算出してカルシウムイオン濃度 を求める。

【0022】第1,第2のフォトマル23,25に基準 電圧HV1、HV2が印加されると、各フォトマルへの 入射光の蛍光強度が電圧信号に変換され、その電圧信号 が各比較回路29,34に入力する。電圧信号の信号値 で表された各蛍光強度が各々のフォトマルのダイナミッ クレンジ内であれば、CPU32により各フォトマルの 測光値の比が演算される。

【0023】ここで、蛍光像の蛍光スペクトルが図6に 示すような波長分布を示すので、第1の吸収フィルター 22の選択波長を410nmに設定し、第2の吸収フィ ルター24の選択波長を460nmに設定すれば、又は 410nmと480nmに設定すれば、2波長間の蛍光 強度比を最も効率良く測定できる。

【0024】CPU32により演算された2波長間の強 度比は、予め用意された2波長間の強度比とカルシウム イオン濃度との関係 (不図示) から、カルシウムイオン 濃度に変換することができる。

【0025】今、第1の吸収フィルター22を透過する 選択波長の蛍光強度が、第1のフォトマル23の検出上 限レベルを越えたとする。この場合、CPU32は図2 20 に示すフローチャートに基づいて感度補正処理を実施す る。すなわち、図4 (a) の上段に示すように、第1の フォトマル23に入射する蛍光強度が、第1のフォトマ ル23の検出上限レベルを越えると、それまで比較回路 29からCPU32へ出力されていた電圧信号の出力が 停止される。

【0026】CPU32では比較回路29からの電圧信 号が入力しなくなったことにより、蛍光強度が第1のフ オトマル23の検出上限レベルを越えたことを検知する (S1) .

【0027】第1のフォトマル23が基準電圧HV1で 光量超過となると、比較回路29から電圧信号が再び出 力されるまで (しきい値Vrefを下回るまで) 第1の フォトマル23の印加電圧を所定の幅で順次下げていく (S2)。電圧信号が比較回路29からCPU32へ再 び入力開始したところ(印加電圧HV1')で感度制御 を止め、印加電圧HV1′での電圧信号から蛍光強度I HV1 ′ を測定する (S3)。

【0028】第1のフォトマル23だけ感度が下げられ ているので、基準感度(基準電圧HV1)での蛍光強度 40 I HV1 を予測する (S4)。この予測演算処理を図4 (a) の感度特性グラフを使って説明する。

【0029】 同図において、

I H V 1 - STD / H V 1 : I H V 1 - STD' / H V 1'

I HV1 /HV1: I HV1 / /HV1/ なる関係が成立するので、下式より蛍光強度 I HV1 を予 測することができる。

[0030]

I HV1 = I HV1 ' (I HV1 -STD/I HV1 -STD')

この予測した蛍光強度 I нv1 と第2のフォトマル25で 50 の蛍光独度比を求めるようにしたので、蛍光独度と各フ

【0031】第2のフォトマル25が基準電圧HV2で 光量超過となった場合には、第2のフォトマル25の印 加電圧を徐々に下げる。そして比較回路34に入力する 電圧信号がしきい値Vrefを下回る印加電圧で蛍光強 度を測光し、その測光値から上述した第1のフォトマル 23と同様の予測演算処理により、基準電圧HV2での 蛍光強度を予測する。

【0032】一方、CPU32はA/D変換器31,3 5 の出力から各フォトマルでの蛍光強度が検出下限レベ ルを下回っていないか否か判断している。A/D変換器 31,35の出力は各フォトマルでの蛍光強度をデジタ ル値で表しているので、CPU32はA/D変換器3 1,35からのデジタル値と所定値(検出下限レベルの 蛍光強度に対応したデジタル値)とを比較して、フォト マルでの蛍光強度が検出下限レベルを下回ったことを判 断する。

【0033】例えば、図4(b)の上段に示すように、 第2の吸収フィルター24を透過する選択波長の蛍光強 度が第2のフォトマル25の検出下限レベルを下回る と、CPU32が図3に示すフローチャートに基づいて 感度補正処理を実施する。すなわち、第2のフォトマル 25が基準電圧HV2で光量不足であると判断すると (T1)、電圧制御回路27を制御して第2のフォトマ ル25の印加電圧を徐々に上げていく (T2)。そして CPU32に入力する蛍光強度のデジタル値が所定値を 越えたならば、その検出下限レベルを越える印加電圧H V 2′での蛍光強度 I Hv2′ を測定する(T 3)。

【0034】第2のフォトマル25だけ感度が上げられ ているので、基準感度(基準電圧HV2)での蛍光強度 IHV2 を予測する (T4)。この予測演算処理を図4

(b) の感度特性グラフを使って説明する。

【0035】同図において、

I H V 2 - STD / H V 2 : I H V 2 - STD' / H V 2' I HV2 /HV2 : I HV2 ' /HV2' なる関係が成立するので、下式より蛍光強度 I HV2 を予 測することができる。

[0036]

I HV2 = I HV2 ' (I HV2 -STD / I HV2 -STD') この予測した蛍光強度 I HV2 と第1のフォトマル23で 検出した I HV1 との比を算出してカルシウムイオン濃度 を求める。

【0037】また第1のフォトマル23の蛍光強度が検 出下限レベルを下回った場合も同様に処理される。この ように本実施例によれば、蛍光強度が各フォトマルのダ イナミックレンジ内に収まらない場合に、フォトマル2 3, 25の感度を補正して蛍光強度をダイナミックレン ジ内に収め、感度特性テーブル36を使って同一感度で



オトマル23,25のダイナミックレンジとの関係に制 限されることなく、幅広い蛍光強度に対して常に高い測 定精度を実現することができる。

【0038】また光路中にNDフィルター等の光量調整 素子を挿入しなくてもダイナミックレンジを適合させる ことができるので、光量損失が小さくなり、常に良好な 観察を行うことができるものとなる。

【0039】なお、上記実施例では蛍光標本の蛍光像を 2波長測光する場合について説明したが、蛍光標本以外 の被検査体の検査にも適用することができる。例えば、 結晶基板の不純物を分析する不純物分析装置に用いるこ 上ができる。

【0040】公知の不純物分析装置では、Arレーザの 所定波長の発振光で被検査体を光励起し、光励起された 被検査体から放出される自由励起子光(FE線)と束縛 励起子光 (BE線) とからなるフォトルミネッセンス光 (PL光)を分光器で分光し、その分光スペクトルにお

けるFE線とBE線の比から不純物を特定している。 【0041】このような不純物分析装置に上述した実施 例の多波長測光装置を応用すれば、上述した実施例の効 20 を示す図である。

果を不純物分析装置でも得ることができる。すなわち、 第1の吸収フィルター22及び第1のフォトマル23と 第2の吸収フィルター24及び第2のフォトマル25 で、FE線とBE線の強度をそれぞれ測定し、両者の比 をCPU32で演算するように構成する。

【0042】このように構成した不純物分析装置によれ ば、分光器を用いることなく不純物分析装置を構成する ことができる。また本発明は2波長測光に限定されるも のではなく3波長以上の測光にも適用できる。

100431

【発明の効果】以上詳記したように本発明によれば、励 起光の光量損失が小さく常に良好な蛍光像を得ることが できると共に、蛍光強度がTVカメラのダイナミックレ ンジやフォトマルのダイナミックレンジから逸脱してい るような場合であっても高い測定精度を実現できる多波 長測光装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る多波長測光装置の全体 10 構成図である。

【図2】図1に示す多波長測光装置における光量超過時

の動作説明図である。 【図3】図1に示す多波長測光装置における光量不足時 の動作説明図である。

【図4】図1に示す多波長測光装置に備えられた感度特 性テーブルに配憶された感度特性を示す図である。

【図5】従来の蛍光顕微鏡の構成図である。


【図6】 蛍光標本が発する光の蛍光強度と波長との関係

【図7】従来の他の蛍光顕微鏡の構成図である。


【符号の説明】


21…ダイクロイックミラー、22…第1の吸収フィル ター、23…第1のフォトマル、24…第2の吸収フィ ルター、25…第2のフォトマル、26,27…電圧制 御回路、29,34…比較回路、32…CPU、36… 威度特性テーブル。


【図5】




[図6]




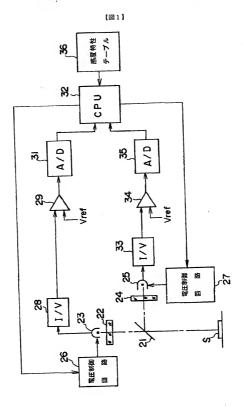



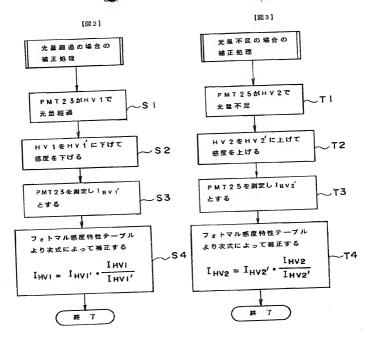



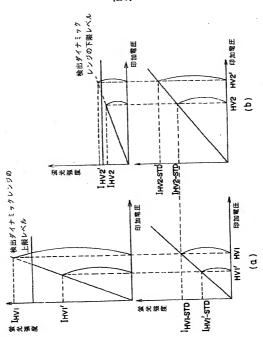

【図7】

